

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079
e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

Oborniki, dn. 21.06.2017r.

L. dz. ZPDK/06/17/176

Znak sprawy: ZPD/06/17

Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów higienicznych, bielizny pościelowej i noworodkowej ogłoszonego w dniu 09.06.2017r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

CZĘŚĆ II ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania

35. Pakiet 1: czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty świadectwa PZH na pieluszki dla dzieci (pozycja 4) ,które to świadectwo potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga załączenia świadectwa PZH.

36. Pakiet 9 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu porodowego w rozmiarze 103 cm x 115cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkład w rozmiarze 103 x 115 cm.

37. Pakiet 21, poz. 1 :

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści fartucha wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²

38. Pakiet 21, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² ze wzmocnieniami wykonanymi z polipropylenu i polietylenu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści fartucha wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² ze wzmocnieniami wykonanymi z polipropylenu i polietylenu.

39. Pakiet 11, pozycja 4: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75 x 45cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionej serwety.

40. Pakiet 12, pozycja 1: czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

serweta z przylepcem	1	L2	240x150
serweta z przylepcem	1	L2	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlacie	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymionego zestawu.

41. Pakiet 12, pozycja 2: czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

serweta z przylepcem	1	L2	240x150
serweta z przylepcem	1	L2	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlacie	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymionego zestawu.

42. Pakiet nr 24 :

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 24 asortyment o wymiarach:

- prześcieradła o wymiarze 150x210 cm,
- serwety o wymiarze 75x100 cm,
- worki Mayo o wymiarze 75x150cm?

Proponowane wymiary wynikają z szerokości konstrukcyjnej tkaniny.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionego asortymentu.

43. Pakiet nr 24 :

Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 24 prześcieradeł, serwet i worków Mayo z dodatkową warstwą chłonną. W opisie przedmiotu zamówienia niestety nie zostały podane wymiary warstw chłonnych.

Najczęściej stosowanymi warstwami chłonnymi w serwetach wchodzących w skład tzw. zestawu uniwersalnego są:

- 40x80 dla prześcieradła,
- 40x60 dla serwety,
- 75x80 dla worka Mayo?

Czy Zamawiający dopuści wymiary serwet wraz z warstwami chłonnymi jak poniżej:

- prześcieradło 150x210 + warstwa chłonna 40x80,
- serweta 75x100 + warstwa chłonna 40x60,
- worek Mayo 75x150 + warstwa chłonna 75x80?

Ewentualnie prosimy o podanie wymaganych przez Zamawiającego warstw chłonnych.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionego asortymentu.

44. Zamawiający w Pakiecie nr 24 wymaga, aby bluzy, spodnie i sukienki były zgodne z normą PNEN 13795 co najmniej w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych i parametrów wytrzymałościowych oraz pełnej zgodności z w/w normą dla prześcieradeł, serwet i worków Mayo.

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty w zakresie Pakietu nr 24 wyników badań potwierdzających zgodność z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie? Tylko na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający może stwierdzić, czy zaoferowane wyroby są zgodne z wymaganiami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga załączenia wyników badań, asortyment ma być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i zgodnie z częścią III SIWZ ust.3 jeśli jest wyrobem medycznym powinien posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP. W razie jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca zostanie wezwany do złożenia odpowiednich dokumentów.

45. Czy Zamawiający wymaga kart technicznych tkanin, z których będzie wykonany asortyment zaoferowany w zakresie Pakietu nr 24, potwierdzających wymagane parametry, tj. gramaturę tkanin oraz skład surowcowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga. Zaoferowany asortyment ma być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, w razie jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca zostanie wezwany do udowodnienia, że zaoferował przedmiot umowy zgodny z wymaganiami.

46. Pakiet nr 25:

Czy Zamawiający dopuści w zakresie Pakietu nr 25 pościel kolorową, tj. pozycje 4 i 5 z jednolitej tkaniny w kolorze pistacjowym lub niebieskim, o gramaturze 120 g/m² oraz składzie 55% bawełna, 45% poliester?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

47. Pakiet nr 25:

Czy Zamawiający dopuści pościel białą, tj. pozycje 1, 2 i 3 z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliester, gramatura zgodnie ze SIWZ?

Proponowana pościel jest bardzo komfortowa oraz trwała.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

48. Zamawiający w zakresie Pakietu nr 25 złożył zapotrzebowanie na bieliznę pościelową. Dla pościeli szpitalnej odpowiednimi wymaganiami świadczącym o jakości wyrobu jest zgodność z Normą ENV 14237 - Tekstylia w ochronie zdrowia. Norma opisuje szereg parametrów mających znaczenie dla trwałości i bezpieczeństwa użytkowania bielizny pościelowej. Aby mieć pewność, że Zamawiający otrzyma wyrób o wysokiej jakości, Wykonawcy powinni potwierdzić zgodność oferowanego asortymentu z w/w normą.

Czy Zamawiający, dbając o jakość przedmiotu zamówienia, wymaga aby pościel biała z Pakietu nr 25 była zgodna z normą ENV 14237, co będzie potwierdzone załączonymi do oferty raportami z badań?

Odpowiedź : Bielizna musi spełniać wymogi dla bielizny pościelowej odpornej na pranie w pralniach typu przemysłowego.

49. Dotyczy: Zadania nr 8 pozycja 1: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony o średnicy 120 cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

50. Dotyczy: Zadania nr 11 pozycja 2 i 3: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem samoprzylepnym fi. 8 cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

51. Dotyczy: Zadania nr 11 pozycja 4: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50 x 50 cm lub 50 x 75 cm lub 75x75 cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

52. Dotyczy: Zadania nr 11 pozycja 6: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 180 x 150 cm z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

53. Dotyczy: Zadania nr 11 pozycja 8: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 100 x 150 cm pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

54. Dotyczy: Zadania nr 11 pozycja 9 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 150 x 200 cm pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

55. Dotyczy: Zadania nr 11 pozycja 6,7,8,9: Czy zamawiający wymaga aby zaoferowane serwety były wykonane z laminatu nieprzemakalnego, chłonnego min. dwuwarstwowego?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

56. Dotyczy: Zadania nr 14 pozycja 2: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony o wymiarach 13 x 244 cm lub 15 x 249 cm

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony o wymiarach 15 x 249 cm.

57. Dotyczy: Zadania nr 14 pozycja 4: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej kieszeni jednokomorowej o wymiarach 30 x 30 cm z podwójną taśmą samoprzylepną?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

58. Dotyczy: Zadania nr 14 pozycja 5: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej kieszeni dwukomorowej o wymiarach 35 x 35 cm lub 40 x 50 cm z podwójną taśmą samoprzylepną?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

59. Dotyczy: Zadania nr 14 pozycja 6: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy o wymiarach 9x51 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

60. Dotyczy: Zadania nr 14 pozycja 1: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 220 x 325 cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

61. Dotyczy: Zadania nr 17 pozycja 1: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów urologicznych z torbą o składzie:

1 x serweta na stół instrumentarium 150 x 200 cm

2 x ręcznik wysoko chłonny

1 x taśma samoprzylepna 9 x 51 cm

1 x serweta do zabiegów TUR z torbą. Wymiary serwety 265/150x180 cm, wyposażona w otwór na pręcie, osłonę per-rectum, worek do przechwytywania płynów z sitem i zaworem. Zestaw spełnia wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę

62. Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny typu Spunlance o gramaturze 45g/m² o długości 92cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

63. Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m² o długości 120cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

64. Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni wykonany w całości z folii PE o kolorze mlecznym?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

65. Pakiet 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny nieprzemakalny w rozmiarze 60x90cm o chłonności 810ml?

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego, nieprzemakalnego w rozm. 60 x 90 cm o chłonności 810 ml.

66. Pakiet 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

67. Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści podkład na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm, z wkładem chłonnym pikowanym 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm, niesterylne, część zewnętrzna laminat nieprzemakalny, o chłonności min. 3850 ml?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

68. Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150kg z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, o chłonności 1,5l/m² ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

69. Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

70. Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne dostępne w rozmiarach S-XXL?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

71. Pakiet 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z przylepnym otworem o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

72. Pakiet 11, pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści serwety z przylepcem wzdłuż krótszego boku?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

73. Pakiet 11, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

74. Pakiet 11, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

75. Pakiet 11, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

76. Pakiet 12, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

+ 1 x kieszeń dwukomorowa pakowana osobno?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

77. Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę z wycięciem w kształcie U w rozmiarze 150x250cm, pakowaną razem z serwetą na stół instrumentalny w rozmiarze 150x190cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

78. Pakiet 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16x250cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

79. Pakiet 14, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

80. Pakiet 14, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyny w rozmiarze 70x120cm, pakowaną a'2sztuki?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

81. Pakiet 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową w rozmiarze 40x30cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

82. Pakiet 14, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

83. Pakiet 14, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści taśmy samoprzylepne w rozmiarze 10x50cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

84. Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

85. Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

86. Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

87. Pakiet 16, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm
- + 1 kieszeń samoprzylepna pakowana osobno?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

88. Pakiet 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 50 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenażu
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

89. Pakiet 21, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuch jednorazowego użytku wykonany z włókniny typu Spunlance?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

90. Pakiet nr 2 – pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie granatowej koszuli wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 38g/m²?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

91. Pakiet nr 2 – pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania koszuli operacyjnej dla pacjenta będącej wyrobem użytkowym? Prośba nasza wynika z faktu iż producent koszuli operacyjnej zakwalifikował ją jako wyrób użytkowy i w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

92. Pakiet nr 8 – pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony na sprzęt medyczny w rozmiarze 85 x 150 cm – pozostałe zapisy zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

93. Pakiet nr 11 – pozycja nr 2-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnych, lepnych serwet z otworem okrągłym – fi 7 cm ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

94. Pakiet nr 11 – pozycja nr 2-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnych serwet o gramaturze min. 55g/m² ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

95. Pakiet nr 11 – pozycja nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety w rozmiarze 45 x 75 cm lub 50 x 50 cm ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety w rozm. 45 x 75 cm.

96. Pakiet nr 12 – pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu służącego do uniwersalnych procedur o następujących parametrach i składzie ?

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta dwuwarstwowa ze wzmocnieniem, przylepna 240 x 150 cm

2 x serweta dwuwarstwowa ze wzmocnieniem, przylepna 90 x 75 cm

1 x serweta dwuwarstwowa ze wzmocnieniem, przylepna 175 x 200 cm

1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm


1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

97. Pakiet nr 12 – pozycja nr 2 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu służącego do uniwersalnych procedur o następujących parametrach i składzie ?

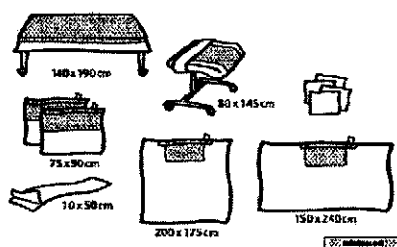

Dodatkowo, niezależnie od zestawu pakowana kieszeń dwukomorowa (rozmiar: 43 x 38 cm).

Skład zestawu:	
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	150 x 240
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	200 x 175
2 samoprzylepne serwetki operacyjne z padem chłonnym	75 x 90
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

pakowana kieszeń samoprzylepna,

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

98. Pakiet nr 14 – pozycja nr 1 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety lepnej ze wzmocnieniem w strefie krytycznej, w rozmiarze 150 x 240 cm z wycięciem w kształcie litery U (65 x 6,5 cm) ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

99. Pakiet nr 14 – pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na przewody w rozmiarze 14 x 250 cm ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

100. Pakiet nr 14 – pozycja nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długich osłon na kończyny w rozmiarze 75 x 120 cm, pakowanych parami ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

101. Pakiet nr 14 – pozycja nr 4-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni bez sztywnika ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

102. Pakiet nr 14 – pozycja nr 4-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni w rozmiarze 43 x 38 cm ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

103. Pakiet nr 14 – pozycja nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 10 x 50 cm ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

104. Pakiet nr 15 – pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety w rozmiarze 320 x 245 cm – pozostałe zapisy zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

105. Pakiet nr 16 – pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety w rozmiarze 320 x 245 cm – pozostałe zapisy zgodne z SIWZ?

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 x serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7) 320 x 225 cm

1 x serweta nieprzylepna 150 x 175 cm

1 x osłona na kończynę 35 x 80 cm


2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

106. Pakiet nr 16 – pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylne go zestawu o następujących parametrach i składzie ?

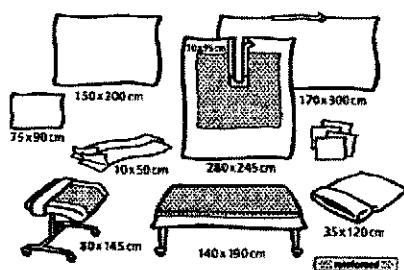


Zestaw do zabiegów w chirurgii biodra II wzmocniony	
Skład zestawu:	
1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna	170 x 300
1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym (10 x 95 cm)	245 x 280
1 serweta nieprzylepna	150 x 200
1 serweta nieprzylepna	75 x 90
1 osłona na kończynę	35 x 120
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

107. Pakiet nr 16 – pozycja nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylne go zestawu o następujących parametrach i składzie ?

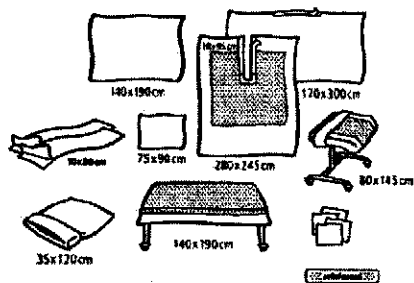

Zestaw do zabiegów w chirurgii biodra wzmocniony II	
Skład zestawu:	
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 x serweta dodatkowa wzmocniona	140 x 190
1 x serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
1 x serweta przylepna	170 x 300
1 x serweta, otwór U przylepny 10 x 95 cm z padem chłonnym	280 x 245
1 x serweta nieprzylepna	75 x 90
1 x osłona na kończynę	35 x 120
2 x taśma przylepna	10 x 50
4 x ręcznik celulozowy	

Dodatkowo, niezależnie od zestawu pakowana kieszeń samoprzylepna, jednokomorowa (rozmiar: 43 x 38 cm).

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

108. Pakiet nr 17 – pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylne, niewzmoczonego zestawu o następujących parametrach i składzie ?

- ▲ 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- ▲ 1 x serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocze (7cm). Wbudowana osłona na palec bezłateksowa do badania per rectum 185 x 200 cm
- ▲ 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- ▲ 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Opakowanie handlowe : 8 zestawów.

Gramatura włókniny, z której wykonana jest serweta główna : min 55 g/m².

Odporność na rozerwanie na sucho/mokro włókniny, z której wykonana jest serweta główna : min. 170 kPa.


Absorbacja włókniny, z której wykonana jest serweta główna : ok. 450 %

Odporność na przenikanie cieczy dla włókniny, z której wykonana jest serweta główna : min. 200 cm H₂O.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

109. Pakiet nr 18 – pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylne zestawu o następujących parametrach i składzie ?

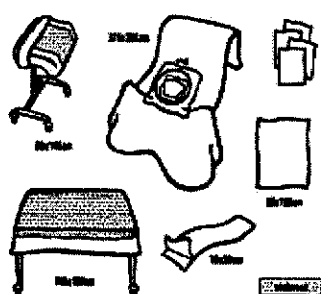


Zestaw do cięcia cesarskiego II		4 zestawy
Skład zestawu:		
1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190	
1 serweta na stół: Mayo wzmocniona	80 x 145	
1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 28 cm)	315 x 250	
1 serweta dla noworodka:	90 x 100	
1 taśma samoprzylepna	10 x 50	
4 ręczniki celulozowe	30 x 33	

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

110. Pakiet nr 18 – pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu o następujących parametrach i składzie ?

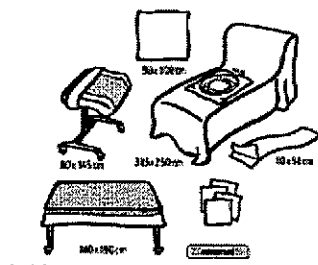


Zestaw do cięcia cesarskiego III		S zestawem
Skład zestawu:		
1 serweta na stółik narzędziowy wzmocniona	140 x 190	
1 serweta na stółik Mayo wzmocniona	80 x 145	
1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 28 cm)	315 x 250	
1 serweta dla noworodka	90 x 100	
1 taśma samoprzylepna	10 x 50	
4 ręczniki celulozowe	30 x 33	

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

111. Pakiet nr 20 – pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu o następujących parametrach i składzie ?

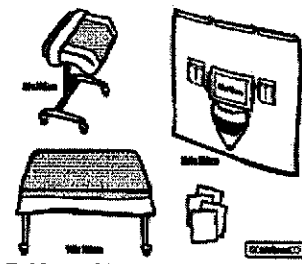


Zestaw pionowy izolacyjny I		
Skład zestawu:		
1 serweta na stółik narzędziowy wzmocniona	140 x 190	
1 serweta na stółik Mayo wzmocniona	80 x 145	
1 serweta PE pionowa – izolacyjna z otworem (30 x 70 cm)	234 x 320	
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm	30 x 33	

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

112. Pakiet nr 20 – pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu o następujących parametrach i składzie ?

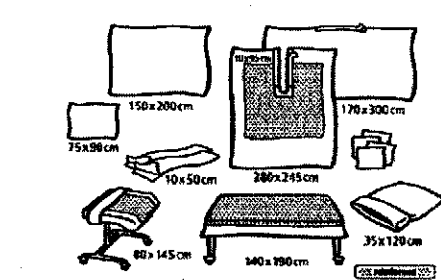

Zestaw do zabiegów w chirurgii biodra II wzmocniony		
Skład zestawu:		
1 serweta na stółik narzędziowy wzmocniona	140 x 190	
1 serweta na stółik Mayo wzmocniona	80 x 145	
1 samoprzylepna serweta operacyjna	170 x 300	
1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonącym (10 x 95 cm)	245 x 380	
1 serweta nieprzylepna	150 x 200	
1 serweta nieprzylepna	75 x 90	
1 osłona na kończynę	35 x 120	
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50	
4 ręczniki celulozowe	30 x 33	

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

SPROSTOWANIE DO I CZĘŚCI ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 19.06.2017r

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 dokonuje sprostowania odpowiedzi udzielonych w dniu 19.06.2017r, dotyczy odpowiedzi nr 6 i 7.

6. Pakiet 11, pozycja 6: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180 x 150cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odповідź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Odповідź powinna brzmieć : Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionej serwety.

7. Pakiet 11, pozycja 9: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180 x 150cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odповідź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Odповідź powinna brzmieć : Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionej serwety.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

